


2015年 6月 検体 冷蔵庫

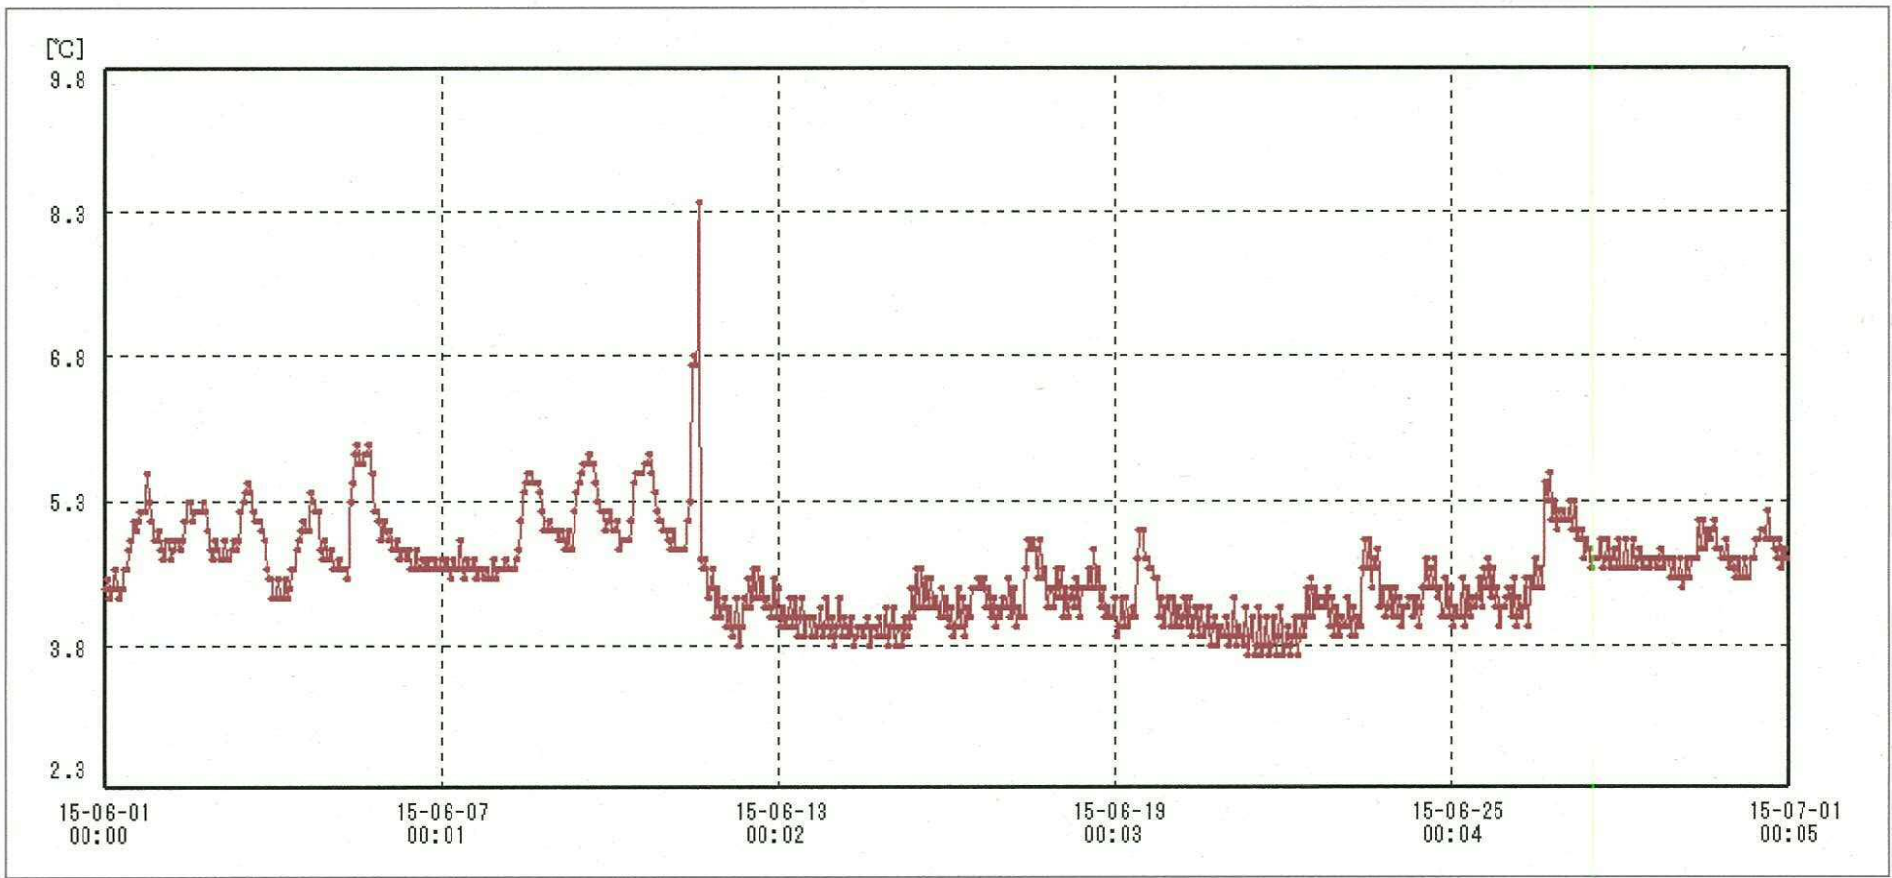

送信器名称 CH番号	冷蔵庫 CH1
▶ グラフ表示	<input checked="" type="checkbox"/>
単位	℃
収録データ数	721
欠損データ数	0
測定間隔	01:00:00
最高値	8.4
最低値	3.7
平均値	4.6