


# 2015年10月 検体冷蔵庫

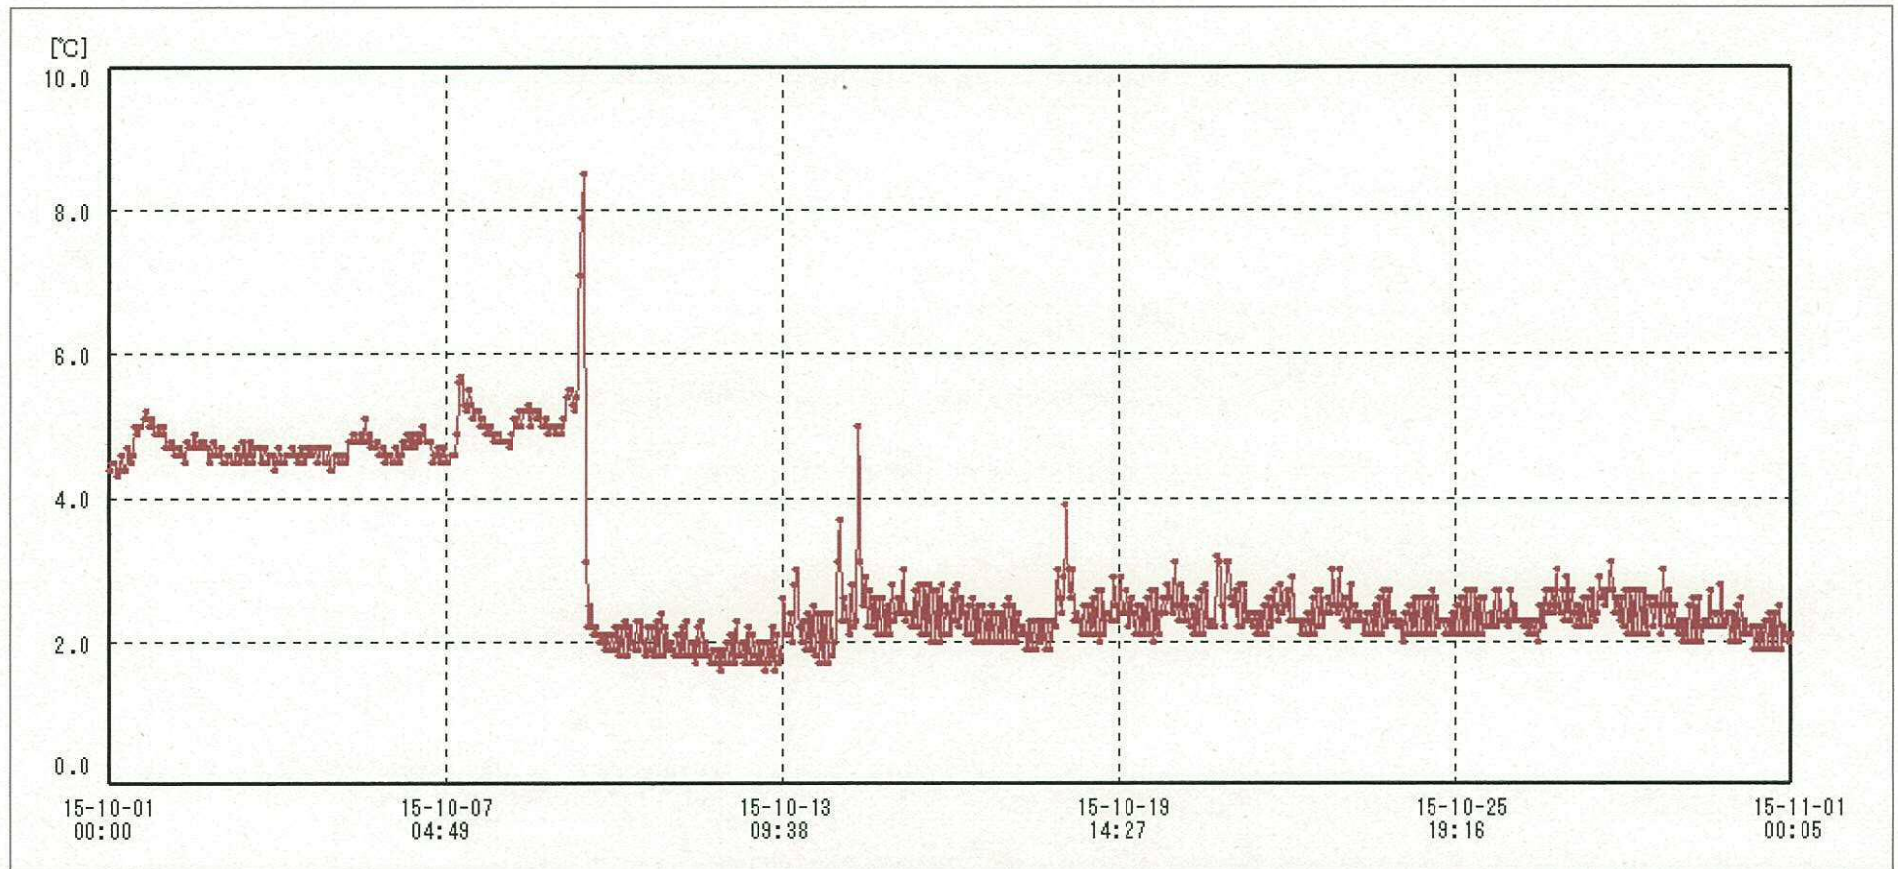

送信器名称 CH番号	冷蔵庫 CH1
▶ グラフ表示	<input checked="" type="checkbox"/>
単位	°C
収録データ数	745
欠損データ数	0
測定間隔	01:00:00
最高値	8.5
最低値	1.6
平均値	3.0