


検体用 冷蔵庫

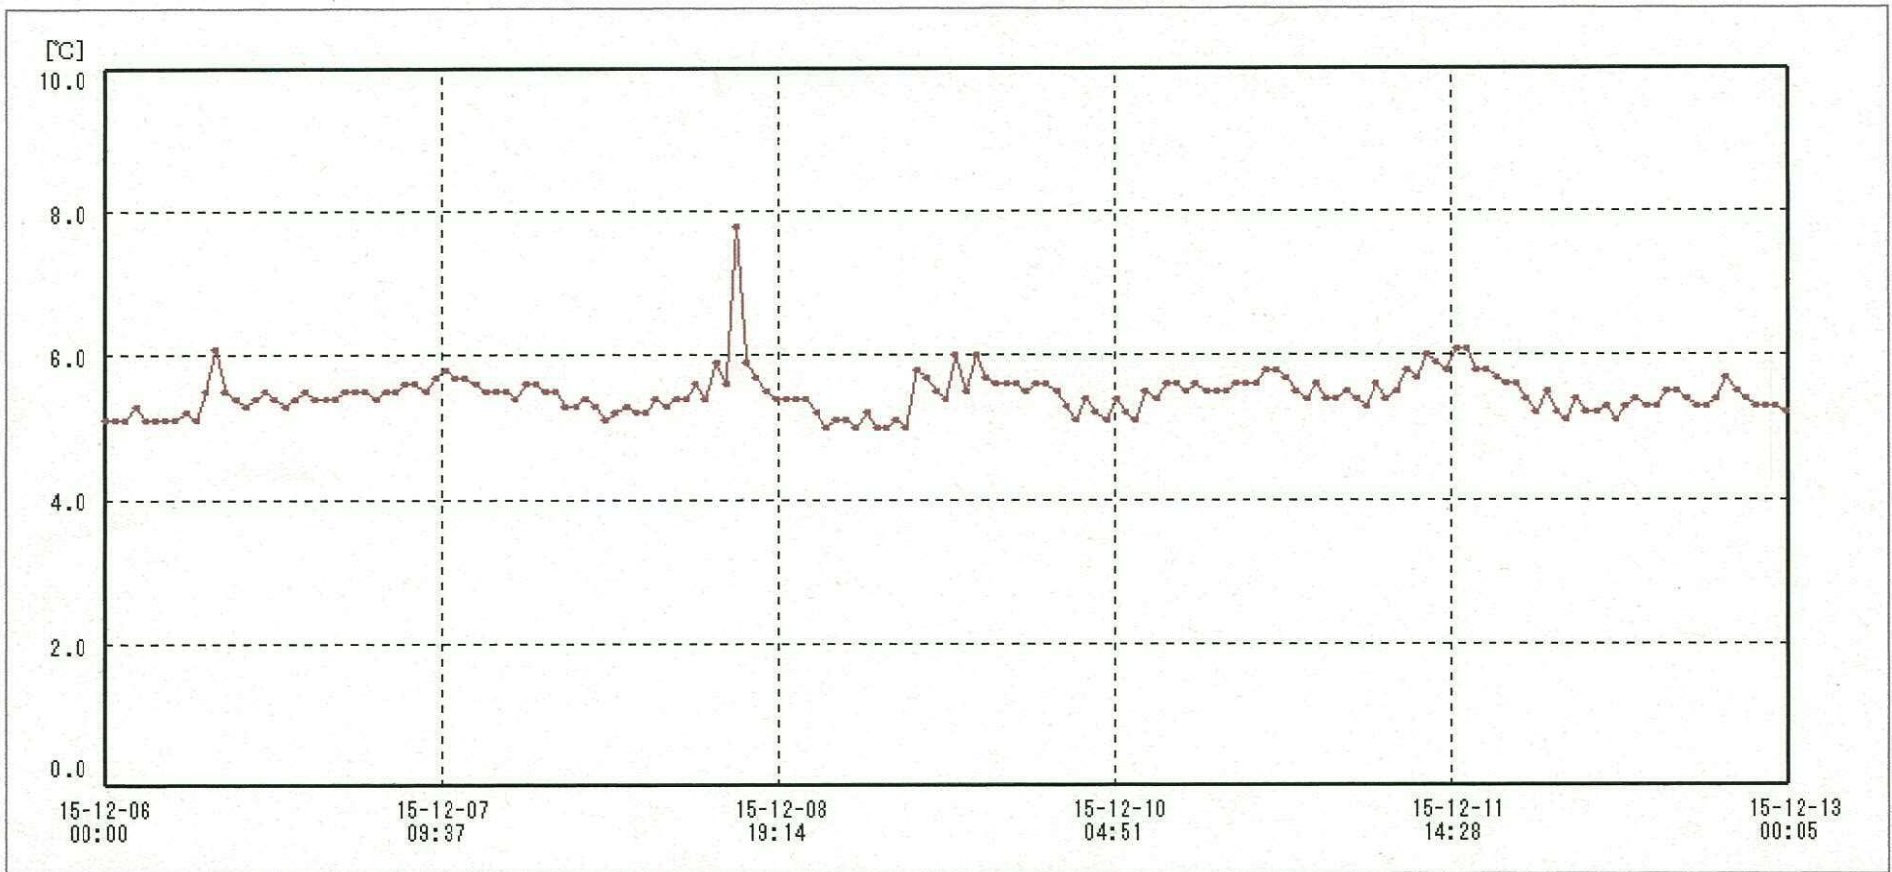

送信器名称 CH番号	冷蔵庫 CH1
▶ グラフ表示	<input checked="" type="checkbox"/>
単位	℃
収録データ数	169
欠損データ数	0
測定間隔	01:00:00
最高値	7.8
最低値	5.0
平均値	5.5

14 / Dec / 2015

南原 沙緒