


検体用 冷蔵庫

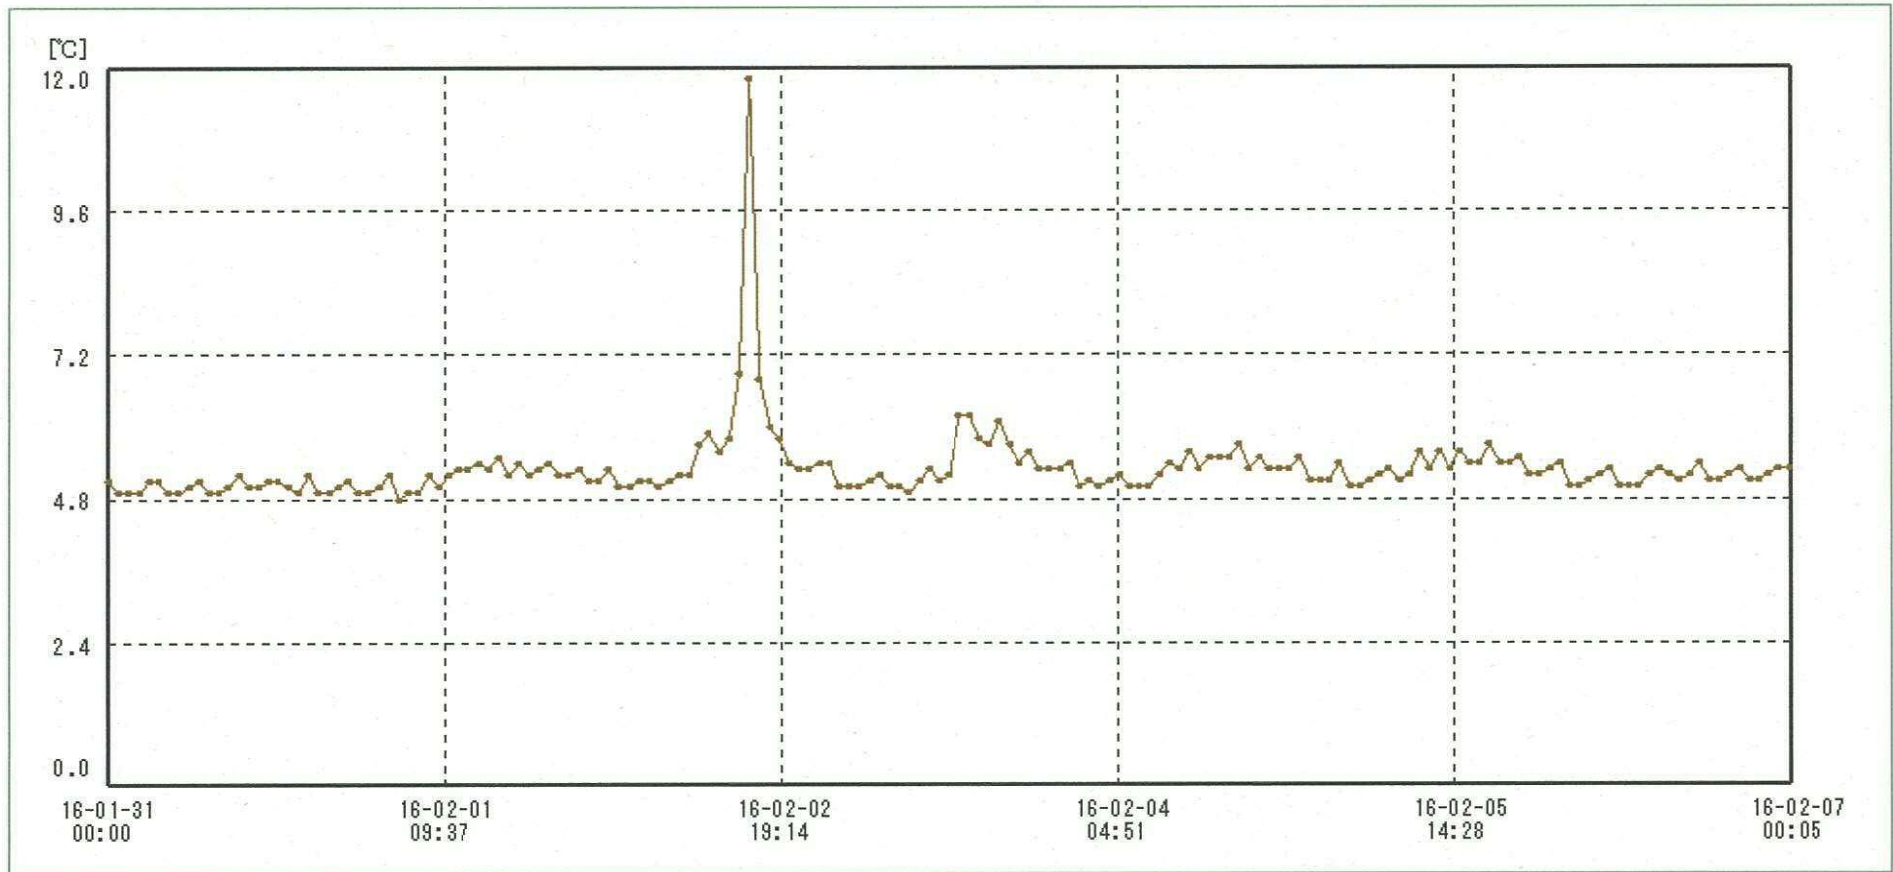

| 送信器名称 CH番号 | 冷蔵庫 CH1 |
|---------------|-------------------------------------|
| ▶ グラフ表示 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 単位 | ℃ |
| 収録データ数 | 169 |
| 欠損データ数 | 0 |
| 測定間隔 | 01:00:00 |
| 最高値 | 11.8 |
| 最低値 | 4.8 |
| 平均値 | 5.3 |

08/Feb/2016 南原沙織