


# 検体用 冷蔵庫

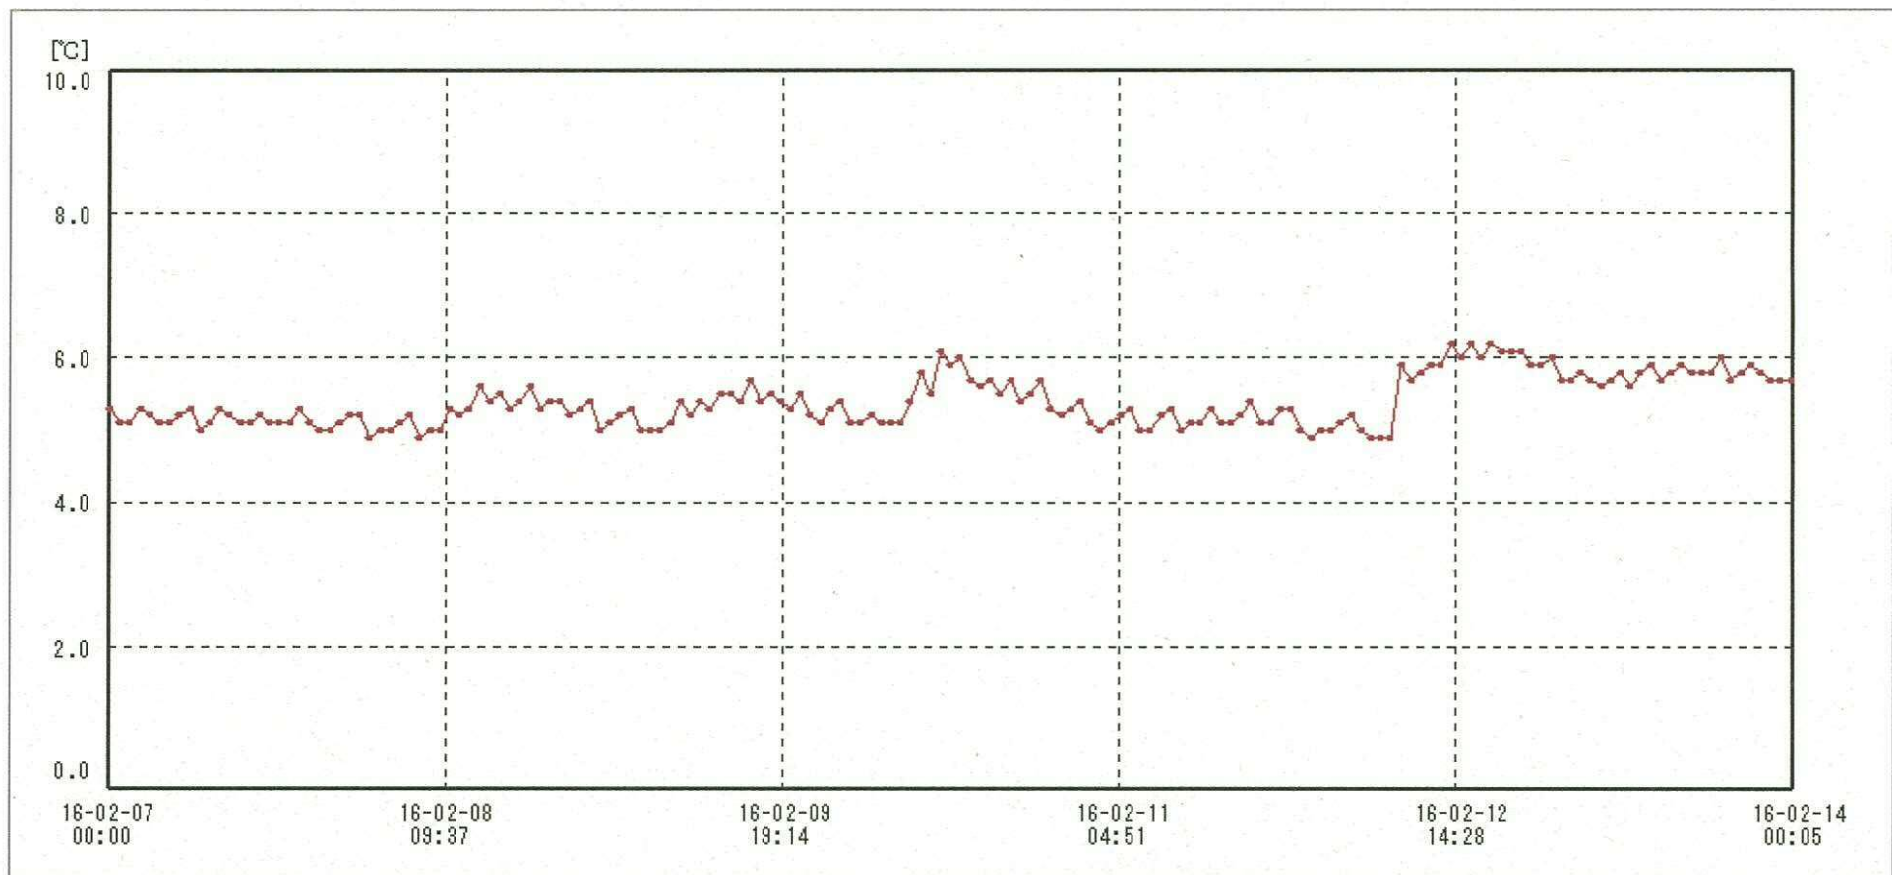

| 送信器名称<br>CH番号 | 冷蔵庫<br>CH1                          |
|---------------|-------------------------------------|
| ▶ グラフ表示       | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 単位            | °C                                  |
| 収録データ数        | 169                                 |
| 欠損データ数        | 0                                   |
| 測定間隔          | 01:00:00                            |
| 最高値           | 6.2                                 |
| 最低値           | 4.9                                 |
| 平均値           | 5.4                                 |

16-Feb-2016 南原沙緒