


# 検体用 冷蔵庫

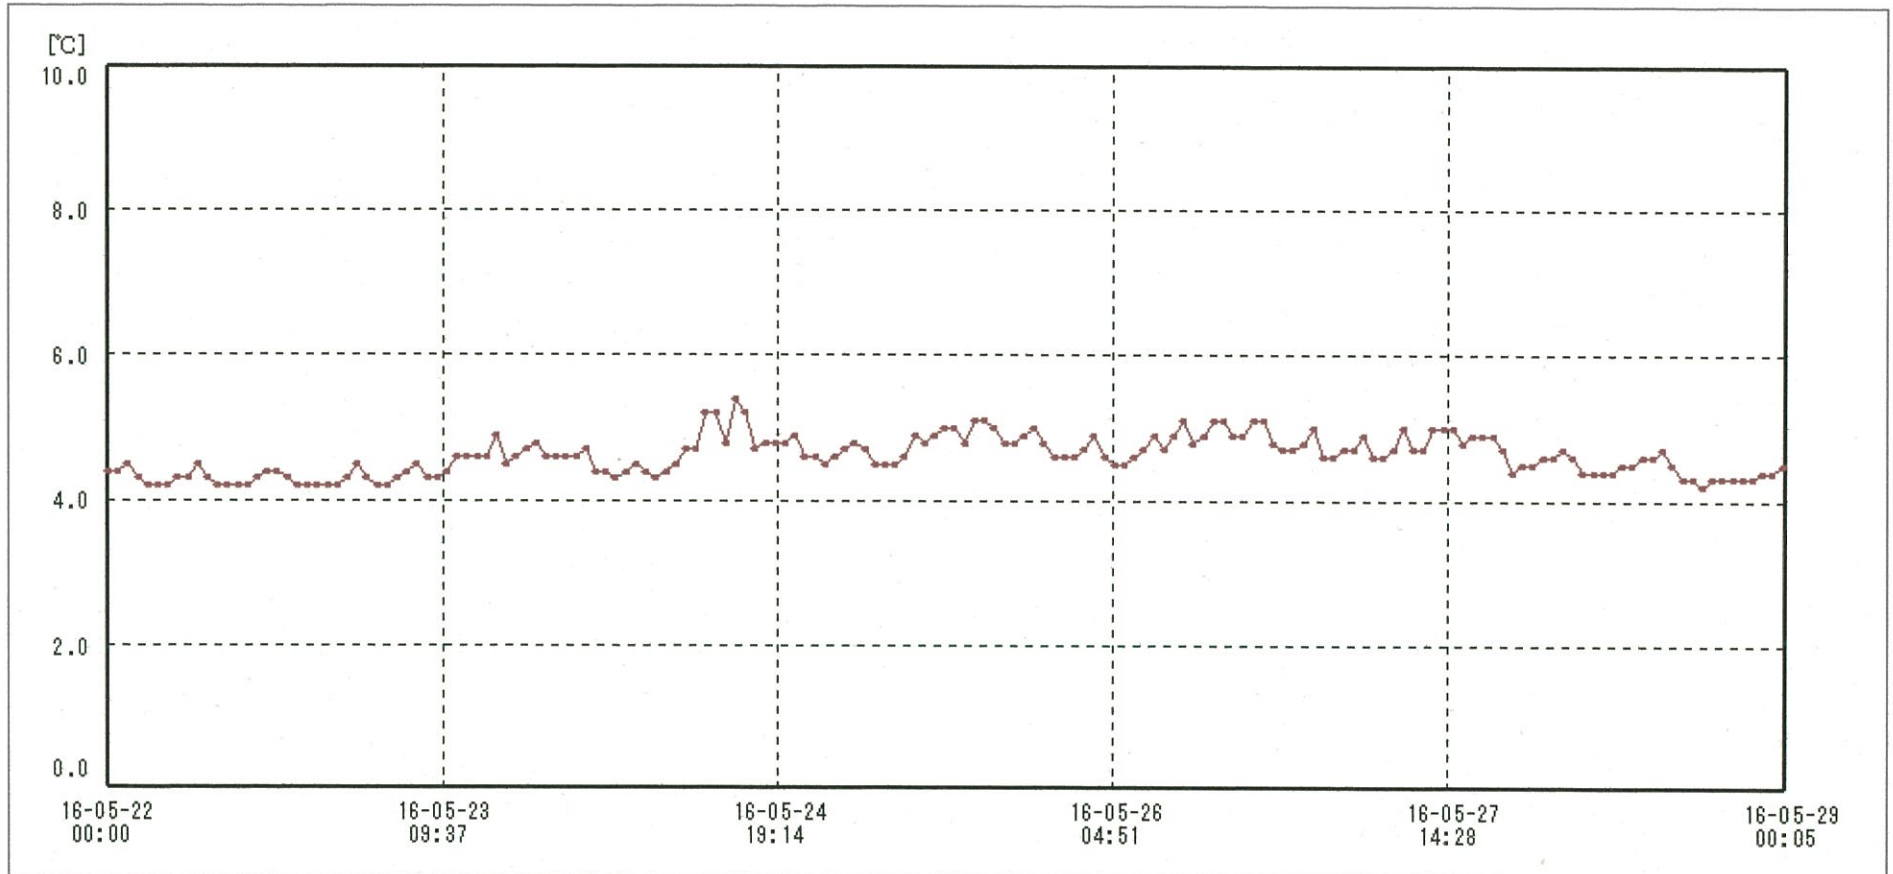

送信器名称 CH番号	冷蔵庫 CH1
▶ グラフ表示	<input checked="" type="checkbox"/>
単位	℃
収録データ数	169
欠損データ数	0
測定間隔	01:00:00
最高値	5.4
最低値	4.2
平均値	4.6

S.N 29-MAY-2016  
31

南原 沙織