

送信器名称 CH番号	冷蔵庫A 0H1
▶ グラフ表示	<input checked="" type="checkbox"/>
単位	°C
収録データ数	211
欠損データ数	0
測定間隔	00:05:00
最高値	6.6
最低値	3.7
平均値	4.7

冷蔵庫更新のため 治験薬を 2014/12/02 17:30 に保管 (温度が 10°C)

09 / Dec / 2014 鈴木 聖

[°C]

10.0


8.2

6.4

4.6

2.8

1.0

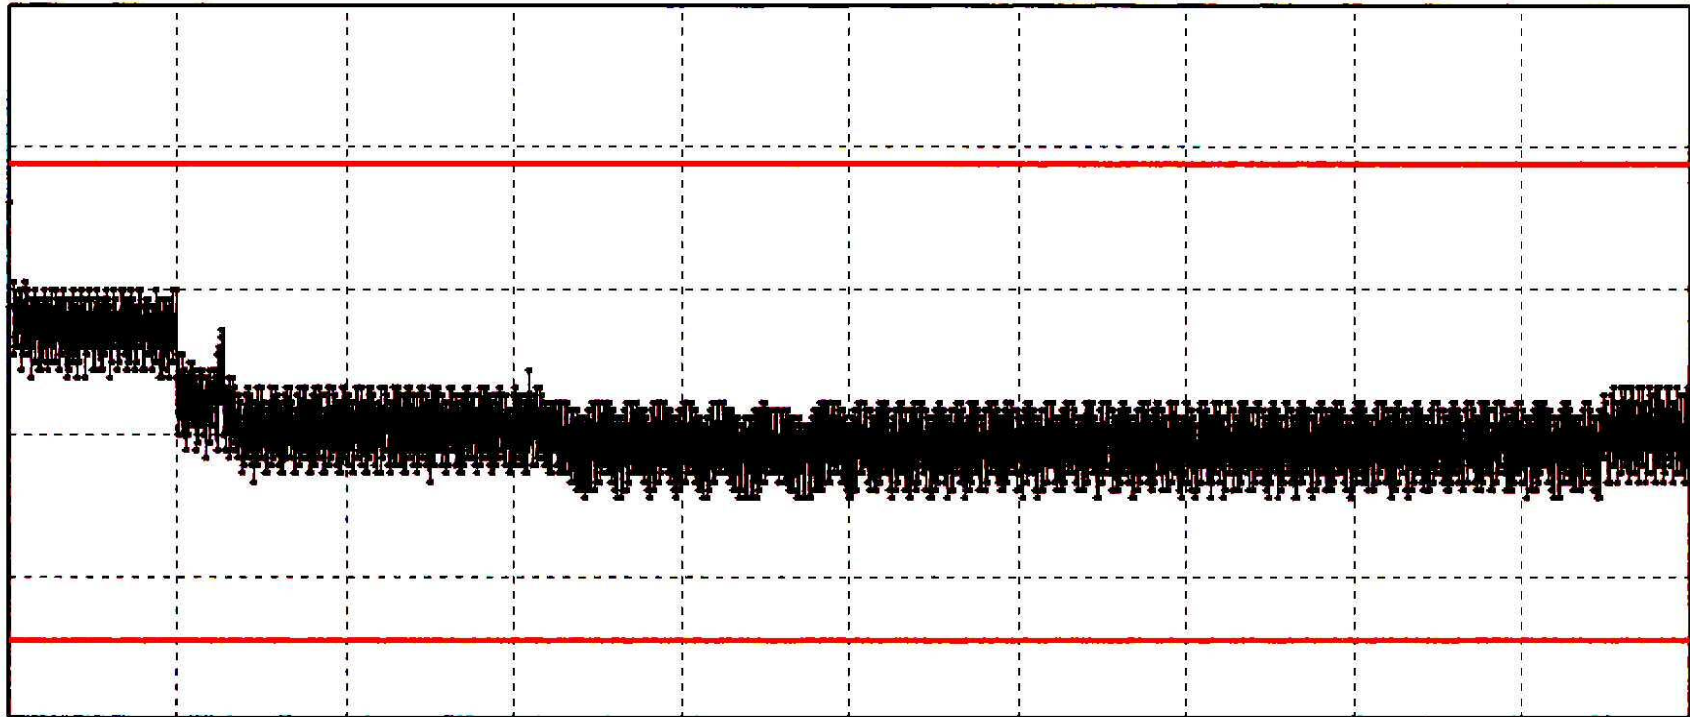

14-12-02  
17:30

14-12-03  
08:33

14-12-03  
23:36

14-12-04  
14:39

14-12-05  
05:42

14-12-05  
20:45

14-12-06  
11:48

14-12-07  
02:51

14-12-07  
17:54

14-12-08  
08:57

14-12-09  
00:00

送信器名称  
CH番号

冷蔵庫A20141202

CHI

▶ グラフ表示

単位

°C

収録データ数

1807

欠損データ数

0

測定間隔

00:05:00

最高値

7.5

最低値

3.8

平均値

4.7

冷蔵庫更新のため治験薬を2014/12/02 17:30から保管開始

(温度ロカ 101D1)

09 / Dec / 2014 鈴木 聖